HANDBUCH

wellion®

LUNA duoStyle

Sehr geehrter Wellion LUNA Duo Style Benutzer,

Danke, dass Sie sich für das Wellion LUNA Duo Style Blutzucker- und Cholesterin-Messsystem entschieden haben. Das Wellion LUNA Duo Style Blutzuckermessgerät wurde entwickelt, um genaue Ergebnisse zu liefern und einfach in der Anwendung zu sein.

Das Wellion LUNA Duo Style Blutzucker- und Cholesterin-Messsystem liefert Ihnen genaue, plasma-kalibrierte Messergebnisse basierend auf der elektrochemischen Biosensor Technologie. Dieses System ermöglicht Ihnen, Blutzucker- und Gesamtcholesterinwerte präzise zu messen und in nur wenigen Sekunden anzuzeigen.

Das Wellion LUNA Duo Style Blutzucker- und Cholesterin-Messsystem wurde entwickelt, um den Blutzucker oder Gesamtcholesterin im Vollblut zu messen. Die Teststreifen dienen der Messung außerhalb des Körpers (In-Vitro-Diagnostik). Sie sollten zur Messung von Blutzucker oder Cholesterin frisches Kapillarblut aus dem Finger verwenden. Das System ist für die Selbstmessung von Blutzucker und Cholesterin zu Hause geeignet, und zur Messung von Patienten durch medizinisches Fachpersonal im professionellen Umfeld.

Bitte lesen Sie die Hinweise in diesem Handbuch sorgfältig und machen Sie sich mit den Abläufen der einzelnen Schritte vertraut, bevor Sie das Messsystem zur Messung von

Blutzucker oder Cholesterin verwenden. Konsultieren Sie Ihren Arzt bevor Sie wichtige medizinische Entscheidungen treffen.

Bei Fragen oder Wunsch nach mehr Information wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen autorisierten Fachhändler.

Wir bedanken uns nochmals, dass Sie sich für das Wellion LUNA Duo Style Blutzucker- und Cholesterin-Messsystem entschieden haben.

Servicenummer:
(+43) 02626 / 64 190 (Österreich)
(+49) 0351 / 253 887 - 0 (Deutschland)

Weitere Informationen unter:
www.medtrust.at oder www.wellion.at
www.medtrust.de oder www.wellion.eu/de

INHALTSVERZEICHNIS

IHR NEUES BLUTZUCKERMESSSYSTEM 6
Anzeige des Wellion LUNA Duo Style Messgerätes 7
Das Wellion LUNA Duo Style Messgerät 8
Der Wellion LUNA Blutzuckerteststreifen 10
Der Wellion LUNA Cholesterinteststreifen 10
Der Wellion LUNA Cholesterin Code-Streifen 10

EINSTELLEN IHRES WELLION LUNA DUO STYLE MESSGERÄTES 11
Einlegen (oder Wechseln) der Batterien 11
Einstellen von Datum und Uhrzeit 12
Kodieren des Messgerätes (nur für die Messung von Gesamtcholesterin) 14

KONTROLLLÖSUNGSTEST 16

MESSEN DES BLUTZUCKERS 20
Vorbereiten der Stechhilfe 20
Messen des Blutzuckers 22
Messen des Gesamtcholesterins 24
Besondere Warnungen 26

ABRUFEN DER GESPEICHERTEN MESSWERTE UND DURCHSCHNITTSWERTE 27

EINSCHRÄNKUNGEN 29
Einschränkungen beim Blutzuckertest 29
Einschränkungen beim Cholesterintest 31

LAGERUNG UND VERWENDUNG DES WELLION LUNA DUO STYLE MESSGERÄTES UND DER WELLION LUNA TESTSTREIFEN 32

PFLEGE DES MESSGERÄTS 33
Pflege des Messgeräts 33
Lagerung und Vorsichtsmaßnahmen 33

PROBLEMBEHEBUNG 35

SYMBOLE 38

HERSTELLERGARANTIE 39

SPEZIFIKATIONEN 40

IHR NEUES BLUTZUCKERMESSSYSTEM

In Ihrem Wellion LUNA Duo Style Blutzuckermesssystem Set sind folgende Bestandteile enthalten:

Wellion LUNA Duo Style Blutzucker- und Cholesterin-Messsystem
Wellion Stechhilfe
10 Wellion Lanzetten
Kompakte Tasche
Handbuch

Anzeige des Wellion LUNA Duo Style Messgerätes

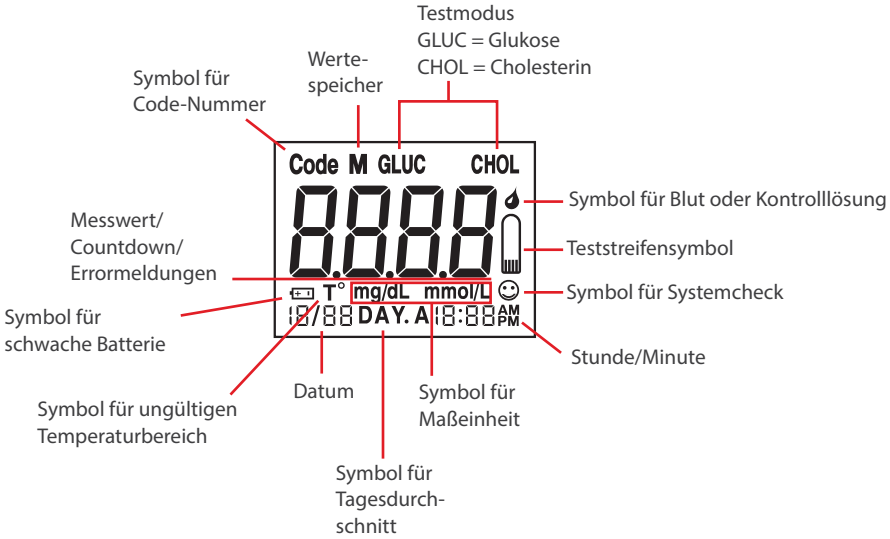

Das Wellion LUNA Duo Style Messgerät

Öffnung für den Teststreifen
Führen Sie hier einen Teststreifen ein um das Messgerät einzuschalten und eine Messung zu beginnen.

Anzeige des Messgerätes
Zeigt die Messergebnisse, gespeicherte Werte, Durchschnittswerte und andere Meldungen.

Memory Taste
Mit der Memory Taste können Sie das Messgerät EIN/AUS-schalten.
Mit der Memory Taste können Sie einzelne Einstellungen im Einstellungsmenü verändern.

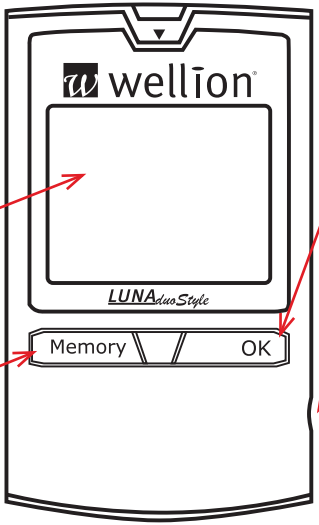

OK Taste
Mit der OK Taste können Sie in den Speicherwerten weiterblättern. Das Drücken der OK Taste bestätigt die von Ihnen gewählten Einstellungen im Einstellungs-Menü.

PC Schnittstelle
Stecken Sie das Datenkabel an, um die Messergebnisse auf einen PC zu übertragen (Datenkabel und Software sind separat erhältlich*).

* Das korrekte Auslesen Ihrer Daten kann nur mit dem Original Wellion LUNA USB Kabel gewährleistet werden.

Das Wellion LUNA Duo Style Messgerät

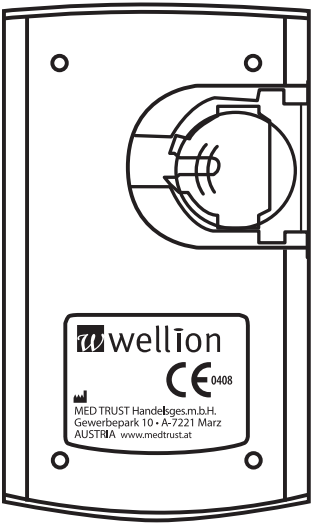



Batteriefach und Batteriefachdeckel
Enthält eine 3V Lithium Batterie (CR2032). Schieben Sie die Abdeckung auf das Batteriefach, um sie zu schließen. Um die Batterie zu entfernen können Sie die Spitze der Abdeckung verwenden.

Akustische Signale
Normaler Hinweiston: Kurzer Piepton
Ton für Warnhinweise: 3 kurze Pieptöne
Ein/Ausschalten: langer Piepton

Der Wellion LUNA Blutzuckerteststreifen

Spitze für die Blutprobe
Bringen Sie die Teststreifenspitze zur Blutprobe oder Kontrolllösung, damit der Teststreifen den Tropfen in den Reaktionsbereich ansaugen kann.

Reaktionsbereich

Kontaktpunkte
Führen Sie dieses Ende in die Teststreifenöffnung, um die Messung zu beginnen

Der Wellion LUNA Cholesterinteststreifen

Spitze für die Blutprobe
Bringen Sie die Teststreifenspitze zur Blutprobe oder Kontrolllösung, damit der Teststreifen den Tropfen in den Reaktionsbereich ansaugen kann.

Reaktionsbereich

Kontaktpunkte
Führen Sie dieses Ende in die Teststreifenöffnung, um die Messung zu beginnen

Der Wellion LUNA Cholesterin Code-Streifen

Kontaktpunkte
Führen Sie dieses Ende in die Teststreifenöffnung des Messgerätes



Code-Nummer
Test Methode: CHOL - Gesamtcholesterin

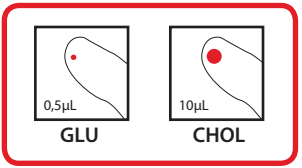

Hinweis: Wenn Ihr Code-Streifen mit Blut oder Kontrolllösung verunreinigt wird, verwenden Sie ein trockenes Tuch oder einen Alkoholtupfer um ihn zu reinigen. Verwenden Sie den Code-Streifen nicht bevor er vollständig trocken ist.

EINSTELLEN IHRES WELLION LUNA DUO STYLE MESSGERÄTES

Einlegen (oder Wechseln) der Batterien

Die Batterie ist bereits in Ihrem neuen Messgerät eingelegt. Verwenden Sie ausschließlich eine 3V Lithium Batterie. Verwenden Sie keine anderen Batterietypen, diese könnten die Elektronik des Messgerätes beschädigen.

1. Entfernen Sie den Batteriefachdeckel

2. Legen Sie eine neue Batterie in die Halterung mit dem „+“-Zeichen nach oben.

3. Schließen Sie das Batteriefach, indem Sie den Deckel fest in die Halterung schieben.

⚠ HINWEIS:

- Im Messgerät bleiben Datum- und Zeiteinstellung für ca. 1 Minute gespeichert. Werden die Batterien nach 1 Minute eingelegt, könnte es sein, dass Datum und Uhrzeit eingestellt werden müssen.
- Gespeicherte Messwerte und Einstellungen werden nicht gelöscht, wenn die Batterien gewechselt werden.

Einstellen von Datum und Uhrzeit

Drücken und halten Sie die OK Taste für ca. 2 Sekunden, bis das Messgerät mit einem Piepton in das Einstellungsmenü wechselt.

⚠ HINWEIS:
- Wurden Datum und Zeit am Wellion LUNA Duo Style Messgerät nicht eingestellt, werden Messergebnisse und Kontrolllösungswerte nicht gespeichert.

1. Im Einstellungsmenü ist zuerst das Jahr einzustellen, das Display zeigt die blinkende Jahreszahl „2013“.

2. Drücken Sie auf die Memory Taste, bis die gewünschte Jahreszahl angezeigt wird.

3. Drücken Sie auf die OK Taste um die Auswahl zu bestätigen und mit der Einstellung des Monats fortzufahren.

4. Drücken Sie die Memory Taste, bis der gewünschte Monat erscheint.

5. Drücken Sie die OK Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen und mit der Einstellung des

Tages fortzufahren.

6. Drücken Sie die Memory Taste, bis der gewünschte Tag erscheint.

7. Drücken Sie die OK Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen und mit der Einstellung der Zeit fortzufahren.

8. Drücken Sie die Memory Taste, bis die gewünschter Stunde erscheint.

9. Drücken Sie die OK Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen und mit der Einstellung der Minuten fortzufahren.

10. Die Stundeneinstellung kann in AM und PM vorgenommen werden.

11. Drücken Sie die Memory Taste, bis die gewünschten Minuten erscheinen.

12. Drücken Sie die OK Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen und die Einstellung von Datum und Zeit abzuschließen.

Nachdem Sie die Einstellungen des Messgerätes durch Drücken der OK Taste beendet haben, schaltet sich das Messgerät mit einem langen Piepton aus.

⚠ HINWEIS:

- Die korrekte Einstellung von Datum und Zeit ist wichtig, wenn Sie die Daten aus dem Messgerätespeicher direkt auf dem Messgerät ansehen oder auf einem Computer auswerten möchten.

Kodieren des Messgerätes (nur für die Messung von Gesamtcholesterin)

Das Wellion LUNA Duo Style Messgerät muss vor der ersten Messung mit Wellion LUNA Cholesterinteststreifen kodiert werden, oder immer wenn eine neue Packung von Wellion LUNA Cholesterinteststreifen geöffnet wird. Es gibt mehrere Arten von Wellion LUNA Teststreifen, Blutzuckerteststreifen und Gesamtcholesterin-Teststreifen, die mit dem Wellion LUNA Duo Style Messgerät verwendet werden können. Nur die Wellion LUNA Gesamtcholesterin-Teststreifen haben einen Code-Streifen in der Teststreifenpackung, um das Messgerät für die Cholesterin-Messung zu kalibrieren.

Es ist NICHT notwendig, das Messgerät für die Blutzuckermessung bzw. Blutzuckerteststreifen zu kodieren.

Überprüfen Sie jedes Mal wenn ein Teststreifen verwendet wird, ob die Code Nummer und der Test Modus, der am Display erscheint, korrekt angezeigt wird.

1. Kontrollieren Sie ob der Testmodus „CHOL“ und die Code-Nummer auf der Dose der Cholesterinteststreifen und dem Code-Streifen übereinstimmen.

2. Stecken Sie den Code-Streifen in die Testreifeneinführung des Messgerätes und warten Sie bis die Code-Nummer am Display erscheint.

3. Versichern Sie sich, dass die Code-Nummer und der Testmodus „CHOL“ auf dem Display mit den Angaben auf der Teststreifendose übereinstimmen.

4. “☺” erscheint am Display und bestätigt die erfolgreiche Kodierung des Messgerätes für die Gesamtcholesterin-Messung.

⚠ HINWEIS:
- Es ist NICHT notwendig das Messgerät für die Blutzuckermessung zu kodieren.

Achtung:
Wenn während des Kodierungs-Prozesses „E-E“ am Display erscheint, könnte ein falscher Code-Streifen verwendet worden sein, oder es gibt möglicherweise ein Problem mit dem Code-Streifen. Wiederholen Sie den Kodier-Vorgang. Wenn „E-E“ wieder erscheint, kontaktieren Sie den lokalen Vertriebspartner.

KONTROLLLÖSUNGSTEST

Der Kontrolllösungstest wird durchgeführt, um die Funktion des Wellion LUNA Duo Style Blutzucker- und Cholesterin-Messgerätes zu überprüfen. Das Messgerät und die Teststreifen funktionieren bestimmungsgemäß, wenn das Kontrolllösungsergebnis in die Zielbereiche fällt, die auf der entsprechenden Teststreifendose angegeben werden.

Verwenden Sie ausschließlich Wellion LUNA Kontrolllösung für Wellion LUNA Teststreifen. Kontrolllösungen anderer Hersteller führen zu ungenauen Ergebnissen.

Das Messsystem sollte überprüft werden,

- Wenn Sie das Messgerät zum ersten Mal verwenden oder eine neue Packung Teststreifen beginnen
- Wenn Sie vermuten, dass das Messgerät oder die Teststreifen nicht ordnungsgemäß funktionieren
- Immer wenn Sie ein unerwartetes Testergebnis bei einer Blutzucker- oder Cholesterin-Messung erhalten
- Wenn das Messgerät zu Boden gefallen ist
- Um den Messvorgang zu üben

1. Führen Sie einen Teststreifen in das Wellion LUNA Duo Style Messgerät ein, wobei die beschriftete Seite zu Ihnen zeigen sollte. Verbiegen Sie den Teststreifen NICHT.

Der jeweilige Testmodus wird am Display angezeigt, je nachdem welchen Teststreifen Sie einführen. Die Anzeige des Messgerätes schaltet sich ein und zeigt das Bild eines blinkenden Blutstropfens, um zu signalisieren, dass das Messgerät bereit ist, Blut über den Teststreifen anzusaugen.

2. Testmodus Blutzucker: Sie können mit der Messung fortfahren, es ist keine Überprüfung eines Kodes notwendig.

Testmodus Gesamtcholesterin: Versichern Sie sich, dass die Code-Nummer mit der Nummer auf der Teststreifendose übereinstimmt.

3. Schwenken Sie die Wellion LUNA Kontrolllösungsflasche vor jedem Kontrolllösungstest, dann öffnen Sie die Kappe, um die ersten 3 Tropfen zu entsorgen. Wischen Sie die Spitze des Fläschchens ab und platzieren Sie einen großen Tropfen Kontrolllösung auf einer sauberen, trockenen, nicht saugenden Oberfläche oder auf der Spitze des Flaschenverschlusses.

4. Tauchen Sie die Spitze des Wellion LUNA Teststreifens in die Wellion LUNA Kontrolllösung, worauf die Kontrolllösung automatisch zum Reaktionsfeld des Teststreifens eingesaugt wird.

5. Beim Wellion LUNA Blutzuckerteststreifen können Sie den Teststreifen vom Tropfen entfernen, sobald ein Piepton zu hören ist.

Wenn „E-8“ am Display erscheint, war die Menge der angesaugten Kontrolllösung zu wenig. Bitte entfernen Sie den gebrauchten Teststreifen und wiederholen Sie den Vorgang mit einem neuen Blutzuckerteststreifen.

6. Beim Wellion LUNA Cholesterinteststreifen können Sie den Teststreifen vom Tropfen entfernen, sobald ein Piepton zu hören ist.

7. Die Messung startet automatisch, sobald genug Kontrolllösung vom Teststreifen angesaugt wurde.

8. Nach dem Countdown zeigt das Wellion LUNA Duo Style Messgerät den Kontrolllösungswert an. Vergleichen Sie das Ergebnis mit den Zielbereichen, die auf der entsprechenden Teststreifendose angegeben sind. Auf jeder Teststreifendose finden Sie die korrekten Zielbereiche, diese können auf verschiedenen Teststreifendosen unterschiedlich sein.

ACHTUNG
Wenn der Testmodus nicht mit dem verwendeten Teststreifen übereinstimmt, entfernen Sie diesen bitte und führen Sie diesen erneut ein oder wiederholen Sie den Vorgang mit einem neuen Teststreifen. Wenn der Testmodus zum wiederholten Male nicht übereinstimmt, kontaktieren Sie den lokalen Vertriebspartner.

Wenn die Testergebnisse nicht mit den angegebenen Zielbereichen auf der Teststrei-

fendose übereinstimmen, könnte es sein, dass das Messgerät oder die Teststreifen nicht ordnungsgemäß funktionieren. Wiederholen Sie die Messung mit Kontrolllösung. Das Messergebnis sollte in den angegebenen Zielbereich fallen, um zu bestätigen, dass das Messgerät und die Teststreifen ordnungsgemäß funktionieren.

Werte außerhalb des Zielbereiches können auftreten:

- Wenn die genannten Schritte der Kontrolllösungs-Messung nicht eingehalten werden
- Wenn der Teststreifen abgelaufen oder beschädigt ist
- Wenn die Kontrolllösung abgelaufen oder verschmutzt ist
- Wenn ein Problem mit dem Messgerät besteht

⚠ HINWEIS:

- Bitte lesen Sie dieses Handbuch und die Anweisungen für einen Kontrolllösungstest sorgfältig vor der Verwendung.
- Verwenden Sie die Wellion LUNA Teststreifen nur einmal und schließen die den Deckel der Teststreifendose unmittelbar nach Entnahme der Teststreifen.
- Die ersten 3 Tropfen Kontrolllösung müssen entsorgt werden und die Flasche muss vor der Messung gründlich geschwenkt werden.
- Neu geöffnete Teststreifen oder Kontrolllösungen können mit dem Öffnungsdatum beschriftet werden.

- Führen Sie keine Blutzuckermessungen oder Cholesterinmessungen durch, wenn das Wellion LUNA Messgerät keine ordnungsgemäßen Kontrolllösungsresultate anzeigt.
- Wenn das Messergebnis außerhalb der Kontrolllösungs-Zielbereiche ausfällt, wiederholen Sie den Kontrolllösungstest. Wenn das Kontrolllösungs-Messergebnis wieder außerhalb des Zielbereiches ausfällt, dann kontaktieren Sie den lokalen Vertriebspartner.

MESSEN DES BLUTZUCKERS

Nach jedem Einschalten des Messgerätes führt das Messgerät eine Systemkontrolle durch.

Vorbereiten der Stechhilfe

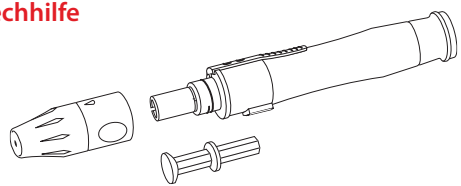

1. Schrauben Sie die verstellbare Kappe von der Stechhilfe ab und führen Sie die Lanzette ein, indem Sie sie bis zum Anschlag fest nach unten drücken..



2. Drehen Sie die Schutzkappe von der Lanzette ab. Schrauben Sie die verstellbare Abdeckkappe wieder im Uhrzeigersinn auf die Stechhilfe auf.



3. Passen Sie die Stechtiefe an der verstellbaren Kappe an (1 ist am wenigsten tief, 5 am tiefsten).

4. Halten Sie mit einer Hand die verstellbare Kappe fest und ziehen Sie die Stechhilfe mit der anderen Hand zurück, bis Sie als Einrastgeräusch ein Klicken hören. Nun ist die Stechhilfe zur Blutgewinnung vorbereitet. Waschen Sie Ihre Hände mit warmem Wasser. Sorgfältig abwaschen und trocknen.



⚠ WICHTIG:

- Verwenden Sie jedes Mal eine neue, sterile Lanzette zum Stechen, um Verunreinigungen zu vermeiden. Sollten Sie Alkoholtupfer zur Reinigung verwenden, warten Sie bis zum vollständigen Trocknen der Messstelle, bevor Sie die Blutprobe gewinnen.

⚠ WICHTIG:

- Die Messung muss innerhalb von 3 Minuten erfolgen, sonst schaltet sich das Wellion LUNA Messgerät automatisch aus. Bitte entfernen Sie dann den Wellion LUNA Teststreifen und führen Sie ihn erneut in die Öffnung ein, um die Messung erneut zu starten.
- Lanzetten und Teststreifen können nicht wiederverwendet werden.
- Bitte verwenden Sie für eine komfortable und sichere Blutgewinnung immer eine Wellion Lanzette.

Messen des Blutzuckers

Für die gleichbleibende Qualität der unbenutzten Teststreifen ist es wichtig, diese immer im geschützten Inneren der Original-Teststreifendose zu belassen. Verschließen Sie die Wellion LUNA Teststreifendose sofort nach Entnahme eines Streifens. Verwenden Sie jeden Teststreifen unmittelbar nach der Entnahme aus der Teststreifendose.

1. Entnehmen Sie einen Wellion LUNA Blutzuckerteststreifen aus der Teststreifendose und verschließen Sie die Dose sofort wieder. Führen Sie den Teststreifen in das Messgerät ein, um es einzuschalten.

2. Führen Sie die Kontaktpunkte des Teststreifens vollständig in die Öffnung am

Messgerät ein. Das Wellion LUNA Duo Style Messgerät wird sich automatisch einschalten und den entsprechenden Testmodus anzeigen. Kontrollieren Sie, ob der angezeigte Testmodus korrekt ist. Für eine Cholesterinmessung wird zusätzlich die Code-Nummer am Display angezeigt.

3. Vergewissern Sie sich bei jeder Messung, dass der angezeigte Testmodus korrekt ist. Ein falscher Testmodus kann zu falschen Messungen oder einer Fehlermeldung führen.
Überprüfen Sie den Testmodus auf der Anzeige, für die Durchführung einer Blutzuckermessung wird „GLUC“ am Display angezeigt.

4. Pressen Sie die Stechhilfe an die Seite der Fingerspitze und drücken Sie den Auslöseknopf, um zu stechen.

5. Tauchen Sie nun vorsichtig die Spitze des Wellion LUNA Teststreifens in einem leichten Winkel in den Blutstropfen. Der Teststreifen saugt wie ein Strohhalm den Blutstropfen ein. Für die Blutzuckermessung wird eine Blutprobe von 0,5 Mikrolitern benötigt. Halten Sie den Teststreifen solange in den Blutstropfen, bis ein Piepton zu hören ist, der anzeigt, dass genügend Blut für die Messung zur Verfügung steht.

Hinweis:
Die Fehlermeldung „E-8“ zeigt an, dass zu wenig Blut für eine Messung im Testbereich des Teststreifens zur Verfügung steht. Bitte entfernen Sie den Teststreifen und wieder-

holen Sie den Test mit einem neuen Teststreifen. Sie können einen größeren Blutstropfen gewinnen, indem Sie die Stechtiefe an der Stechhilfe justieren. Zur Blutzuckermessung benötigen Sie ca 0,5 µL Blut.

6. Nach dem Countdown zeigt das Messgerät das Ergebnis am Display an.

7. Entfernen Sie den benutzten Teststreifen aus dem Messgerät.
Entfernen Sie die benutzte Lanzette aus der Stechhilfe. Sie können dafür die Auswurftaste verwenden, um Stichverletzungen zu vermeiden. Schieben Sie die Auswurftaste mit dem Daumen nach vorne und ziehen Sie gleichzeitig die Spannhülse nach hinten, um die gebrauchte Lanzette auszuwerfen. Entsorgen Sie die Lanzette ordnungsgemäß.

Messen des Gesamtcholesterins

Für die gleichbleibende Qualität der unbenutzten Teststreifen ist es wichtig, diese immer im geschützten Inneren der Original-Teststreifendose zu belassen. Verschließen Sie die Wellion LUNA Teststreifendose sofort nach Entnahme eines Streifens. Verwenden Sie jeden Teststreifen unmittelbar nach der Entnahme aus der Teststreifendose.

Bitte kodieren Sie ihr Wellion LUNA Messgerät mit dem Wellion LUNA Cholesterin Code-Streifen bevor Sie eine neue Packung Wellion LUNA Cholesterin-Teststreifen beginnen. Sie müssen Ihr Messgerät nur einmal zu Beginn einer neuen Packung

Cholesterin-Teststreifen mit dem beileigenden Code-Streifen kodieren. Eine Kodierung ist nicht vor jeder Messung notwendig.

1. Entnehmen Sie einen Wellion LUNA Cholesterinteststreifen aus der Teststreifendose und verschließen Sie die Dose sofort wieder. Führen Sie den Teststreifen in das Messgerät ein, um es einzuschalten.
Hinweis: Vermeiden Sie es, den Teststreifen an der Stelle des Reaktionsfeldes zu fest zu drücken, um ungenauen Ergebnissen vorzubeugen.

2. Überprüfen Sie den Testmodus auf der Anzeige, für die Cholesterinmessung wird „CHOL“ angezeigt. Wenn nicht, entfernen Sie den Teststreifen und führen Sie einen Cholesterin-Teststreifen ein, bis „CHOL“ auf der Anzeige erscheint. Zusätzlich wird eine Code-Nummer angezeigt. Überprüfen Sie, ob die Code-Nummer mit der Nummer auf der Teststreifendose übereinstimmt. Falls die Code-Nummer nicht übereinstimmt, kodieren Sie das Messgerät erneut (siehe Kapitel „ Kodieren des Messgerätes“) und führen Sie einen neuen Cholesterinteststreifen ein.

3. Tauchen Sie nun vorsichtig die Spitze des Wellion LUNA Teststreifens in einem leichten Winkel in den Blutstropfen. Der Teststreifen saugt wie ein Strohhalm den Blutstropfen ein. Für die Cholesterinmessung wird eine Blutprobe von 10 Mikrolitern benötigt Halten Sie den Teststreifen solange in den Blutstropfen, bis ein Piepton zu hören ist, der anzeigt, dass genügend Blut für die Messung zur Verfügung steht.

⚠ HINWEIS:

- Das Wellion LUNA Duo Style Blutzucker- und Cholesterin-Messsystem und die dazugehörigen Wellion LUNA Teststreifen sind plasmakalibriert.
- Verwenden Sie die Wellion LUNA Teststreifen innerhalb der angegebenen Mindeshaltbarkeitsdauer. Wellion LUNA Blutzuckerteststreifen können innerhalb von 6 Monaten nach dem ersten Öffnen der Teststreifendose verwendet werden, Wellion LUNA Gesamtcholesterinteststreifen können 3 Monate nach dem ersten Öffnen der Teststreifendose verwendet werden.
- Vermeiden Sie ein Nachtropfen von Blut, um ungenaue Testresultate zu verhindern.
- Verwenden Sie keine gebrauchten Teststreifen. Falls Sie einen gebrauchten Teststreifen einführen, erscheint die Fehlermeldung „E-U".
- Falls Sie das falsche Ende des Teststreifens bzw den Teststreifen nicht mit der bedruckten Seite nach vorne einführen, wird sich das Messgerät nicht einschalten.

Besondere Warnungen

	Lo	**Hi**
Glukose	< 20 mg/dL	> 600 mg/dL
Gesamt-Cholesterin	< 100 mg/dL	> 400 mg/dL

ABRUFEN DER GESPEICHERTEN MESSWERTE UND DURCHSCHNITTSWERTE

Das Wellion LUNA Duo Style Blutzucker- und Cholesterin-Messsystem speichert bis zu 410 Messergebnisse – 360 Blutzuckermesswerte und 50 Gesamtcholesterinmesswerte. Es bietet außerdem die Möglichkeit, die 7-, 14-, 21- und 28-Tagesdurchschnitte für Blutzucker anzuzeigen.

1. Vergewissern Sie sich, dass in der Teststreifenöffnung am Wellion LUNA Duo Style Messgerät kein Teststreifen steckt. Drücken und halten Sie die Memory Taste für ca. 3 Sekunden um den Speichermodus einzuschalten. Das Messgerät zeigt kurz alle Elemente der Anzeige gefolgt von einem langen Piepton und wechselt in den Speichermodus.

2. Das Icon „GLUC“ oder „CHOL“ blinkt am oberen Rand der Anzeige, je nachdem in welchem Speichermodus Sie sich befinden. Drücken Sie die Memory Taste, um zwischen den beiden Modi hin und her zu schalten und drücken Sie OK, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Hinweis: Das „CHOL“ Icon blinkt zusammen mit der Code-Nummer, wenn das Messgerät im Cholesterin-Modus eingestellt ist.

3. Sobald Sie in den Blutzucker-Speichermodus wechseln, wird der 7-Tage-

Durchschnitt zuerst angezeigt, dann nacheinander der 14-, 21- und 28-Tagesdurchschnitt.
Hinweis: Nur der Blutzucker-Speichermodus bietet die Anzeige der Tagesdurchschnittswerte. Der Speichermodus für Cholesterin kann keine Durchschnittswerte anzeigen.

4. Nach dem 28-Tagedurchschnitt (28 D.AVG) erscheint das zuletzt gespeicherte Messergebnis auf der Anzeige. Drücken Sie die OK Taste, um zum nächsten Messergebnis weiter zu gehen. Die Anzeige zeigt abwechselnd den Blutzuckerwert und die Nummer des Messwertes im Speicher.
Drücken Sie die Memory Taste können Sie direkt zwischen den Speicher-Modi (Blutzucker und Cholesterin) wechseln.

5. Drücken und halten Sie die Memory Taste, für ca. 3 Sekunden, um das Messgerät auszuschalten. Nach einer Minute ohne Verwendung schaltet sich das Messgerät automatisch aus.

⚠ HINWEIS:
- Befinden sich bereits 360 Werte im Blutzucker-Wertespeicher, wird bei einem neuen Wert der jeweils älteste überschrieben.
- Befinden sich bereits 50 Werte im Cholesterin-Wertespeicher, wird bei einem neuen Wert der jeweils älteste überschrieben.

EINSCHRÄNKUNGEN

Bitte beachten Sie folgende Einschränkungen für den Erhalt genauer Ergebnisse mit dem Wellion LUNA Mess-System:

- ausschließlich für In-Vitro-diagnostischen Gebrauch (nur zum äußeren Gebrauch)
- Wellion Blutzuckerteststreifen können nur einmalig verwendet werden. Nicht wiederverwenden.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Messgerätes, wenn direkt daneben mit einem Mobiltelefon telefoniert wird; vermeiden Sie elektronische Störungen.

Einschränkungen beim Blutzuckertest

Wellion LUNA Blutzucker-Teststreifen geben genaue Ergebnisse, wenn die folgenden Einschränkungen beachtet werden:

- Der Hämatokrit (Hct) könnte Ihr Messergebnis beeinflussen. Ein Hämatokrit unter 25% könnte falsch höhere Ergebnisse bringen, ein Hämatokrit höher als 60% könnte etwas niedrigere Ergebnisse bringen. Konsultieren Sie Ihren Arzt um Ihren Hämatokritwert bestimmen zu lassen.
- Verwenden Sie Wellion LUNA Blutzuckerteststreifen nicht für Messungen an Neugeborenen.
- Die Teststreifen reagieren ausschließlich mit D-Glukose und nicht mit anderen, eventuell im Blut befindlichen Zuckerarten.

- Verwenden Sie ausschließlich frisches kapillares Vollblut aus der Fingerbeere. Verwenden Sie kein Serum oder Plasma.
- Wellion LUNA Blutzuckerteststreifen können bis zu einer Seehöhe von 3.048 m (10.000 feet) ohne einen Effekt auf das Ergebnis verwendet werden.

Weitergehende Information für medizinisches Fachpersonal:

- Wird venöses Blut für den Test verwendet, kann dieses in heparinisierten Röhrchen bis zu 30 Minuten nach der Abnahme gelagert werden. Das Messergebnis kann rund 7% niedriger sein als bei einer kapillaren Blutprobe.
- Interferenzen: Acetaminophen, Harnsäure, Ascorbinsäure, Dopamin, Gentisinsäure, Ibuprofen, Methyldopa, Salicylat, Tetracyclin, Tolazamid, Tolbutamid (bei physiologischen oder therapeutischen Konzentrationen) beeinflussen das Messergebnis nicht signifikant.
- Patienten die sich einer Sauerstofftherapie unterziehen, könnten falsch niedrigere Werte erhalten
- In Fällen verminderter peripherer Durchblutung, wie z.B. bei starker Dehydrierung, während eines Schocks oder einer hyperosmolaren Zustands (mit oder ohne Ketose) oder hohem Blutdruck könnten die Messergebnisse falsch niedriger sein.
- Wellion LUNA Teststreifen sind auf Plasma kalibriert. Verwendung von Serum- oder Plasmaproben führt zu falsch höheren Messergebnissen
- Wellion LUNA Blutzuckerteststreifen wurden nicht für die Messung von neonatalen Blutproben validiert
- Lipämische Proben: Cholesterolkonzentrationen bis zu 400 mg/dl und Triglyzeridkonzentrationen bis zu 3000 mg/dl beeinflussen das Ergebnis nicht. Extrem lipämische Patientenproben wurden nicht getestet und daher wird in diesem Fall die Messung mit Wellion LUNA Teststreifen nicht empfohlen.
- Bei manchen schweren Erkrankungen soll die Blutzuckerbestimmung mittels eines Laborgerätes erfolgen.

Einschränkungen beim Cholesterintest

Wellion LUNA Cholesterin-Teststreifen geben genaue Ergebnisse, wenn die folgenden Einschränkungen beachtet werden:

- Der Hämatokrit (Hct) könnte Ihr Messergebnis beeinflussen. Ein Hämatokrit unter 35% könnte falsch höhere Ergebnisse bringen, ein Hämatokrit höher als 50% könnte etwas niedrigere Ergebnisse bringen. Konsultieren Sie Ihren Arzt um Ihren Hämatokritwert bestimmen zu lassen
- Verwenden Sie ausschließlich frisches kapillares Vollblut aus der Fingerbeere. Verwenden Sie kein Serum oder Plasma.
- Wellion LUNA Cholesterin-Teststreifen können bis zu einer Seehöhe von 2.438 m (8.000 feet) ohne einen Effekt auf das Ergebnis verwendet werden.

Weitergehende Information für medizinisches Fachpersonal:

- Interferenzen: Acetaminophen, Harnsäure, Ascorbinsäure, Dopamin, Gentisinsäure, Ibuprofen, Methyl-Dopa, Salicylate (bei physiologischen oder therapeutischen Konzentrationen) haben keinen signifikanten Effekt auf das Messergebnis. Hämoglobin in physiologischen Konzentrationen ≤10 mg/dL.
- In Fällen verminderter peripherer Durchblutung, wie z.B. bei starker Dehydrierung, während eines Schocks oder einer hyperosmolaren Zustands (mit oder ohne Ketose) oder hohem Blutdruck könnten die Messergebnisse falsch niedriger sein.
- Wellion LUNA Cholestrin-Teststreifen sind auf Plasma kalibriert. Verwendung von Serum- oder Plasmaproben führt zu falsch höheren Messergebnissen.
- Spezielle Blutproben: Blutzuckerspiegel bis zu einer Höhe von 476 mg/dl haben keinen signifikanten Einfluss auf die Bestimmung des Gesamtcholesterins. Extrem lipämische Patientenproben wurden nicht getestet und daher wird in diesem Fall die Messung mit Cholesterin-Teststreifen nicht empfohlen.

LAGERUNG UND VERWENDUNG DES WELLION LUNA DUO STYLE MESSGERÄTES UND DER WELLION LUNA TESTSTREIFEN

Die Funktionsweise der Wellion LUNA Teststreifen kann durch unsachgemäße Lagerung oder Verwendung beeinflusst werden.

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Lagern Sie das Wellion LUNA Messgerät zw 0 – 60°C, den Code-Streifen, die Teststreifen und die Kontrolllösung zw 4 – 30°C.
- Lagern Sie Teststreifen nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit oder an extrem heißen oder kalten Orten.
- NICHT EINFRIEREN. Lagern Sie Teststreifen und das Messgerät bei Raumtemperatur.
- Bei Verunreinigung des Messgerätes verwenden Sie ein feuchtes (NICHT NASSES) fusselfreies Tuch mit einer milden Reinigungslösung.
- Achten Sie darauf, die Teststreifen nur mit sauberen, trockenen Händen zu berühren. Waschen Sie die Hände und die Messstelle sorgfältig mit warmen Wasser und Seife und trocknen Sie sie gut ab.
- Verwenden Sie das Messgerät nicht in sehr trockener Umgebung, vor allem wenn synthetische Materialien vorhanden sind. Es kann zu schädlichen statischen Entladungen in einer trockenen Umgebung führen.
- Verwenden Sie das Messgerät nicht in der Nähe von elektrischen oder elektronischen Geräten die Quellen elektromagnetischer Strahlung sind, da diese den ordnungsgemäßen Betrieb des Messgerätes beeinträchtigen können.

PFLEGE DES MESSGERÄTS

Die Pflege Ihres Wellion LUNA Duo Style Blutzucker- und Cholesterin-Messsystems ist sehr einfach. Folgen Sie diesen einfachen Richtlinien, um die Leistungsfähigkeit Ihres Messgeräts zu erhalten.

Pflege des Messgeräts

- Bei Verunreinigung des Messgeräts verwenden Sie ein feuchtes (NICHT NASSES), fusselfreies Tuch mit einer milden Reinigungslösung.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Wellion LUNA Duo Style Messgerät eindringt. Tauchen Sie das Messgerät niemals unter Wasser und halten Sie es niemals unter fließendes Wasser.
- Verwenden Sie keine Glas- oder Haushaltsreiniger für das Messgerät.
- Versuchen Sie nicht, die Öffnung für die Teststreifen zu reinigen.

Lagerung und Vorsichtsmaßnahmen

- Behandeln Sie das Messgerät sorgfältig – schwere Erschütterungen, wie sie z.B. beim Herunterfallen des Messgeräts auftreten, könnten die Elektronik beschädigen.

- Vermeiden Sie, das Messgerät in der Nähe von magnetischen, elektromagnetischen oder radioaktiven Feldern zu lagern oder zu verwenden..
- Wellion LUNA Messgerät und Streifen arbeiten in einem Temperaturbereich zwischen 4°C und 45°C.
- Vermeiden Sie es, das Messgerät an extrem heißen oder kalten Orten aufzubewahren, wie z.B. nahe einer Heizquelle oder in einem extrem heißen oder kalten Auto.
- Vermeiden Sie es, das Wellion LUNA Messgerät oder die Teststreifen an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit zu lagern oder zu benutzen, wie z.B. im Badezimmer oder in der Küche.
- Verschließen Sie den Deckel der Teststreifendose immer unmittelbar nach der Entnahme eines Teststreifens und vergewissern Sie sich, dass er fest sitzt.
- Zerlegen Sie das Messgerät nicht in seine Einzelteile. Dadurch würde die Garantie erlöschen. Bei technischen Problemen oder Fragen wenden Sie sich an Ihren autorisierten Fachhändler.

PROBLEMBEHEBUNG

In diesem Abschnitt werden signifikante Meldungen und Errorcodes auf der Anzeige erklärt, die beim Gebrauch Ihres Wellion LUNA Duo Style Messgeräts und der Teststreifen auftreten können.

Was Sie sehen	Was es bedeutet	Was Sie tun sollten
E-0	Fehler beim Kodieren	Führen Sie den Code-Streifen erneut ein oder wiederholen Sie die Messung mit einem neuen Teststreifen. Sollte das Problem wieder auftreten, kontaktieren Sie den lokalen Vertriebspartner.
E-b	Batterie ist schwach	Ersetzen Sie die Batterie wie im Kapitel: Einlegen (oder Ersetzen) der Batterie beschrieben
Err3	Die Referenzspannung oder eine Schaltung ist fehlerhaft.	Kontaktieren Sie den lokalen Vertriebspartner für Hilfe und Service.
E-t & Temperatursymbol	Die Umgebungstemperatur liegt außerhalb der Betriebstemperatur des Messsystems.	Bringen Sie das Messgerät in eine Umgebung mit einer Temperatur zwischen 4°C und 45°C und warten Sie 30 Minuten, bis die Umgebungstemperatur erreicht ist.

E-E	1. Es könnte ein Problem mit der automatischen Systemkontrolle des Messgerätes geben. 2. Verwendung eines falschen oder beschädigten Code-Streifens 3. Code-Streifen wurde nicht richtig eingeführt	Schalten Sie das Messgerät aus und führen Sie anschließend den Teststreifen neu ein. Sollte das Problem wieder auftreten, rufen Sie uns unter der auf der Packung angegebenen Telefonnummer an. Überprüfen Sie, ob die Code-Nummer auf der Anzeige mit der Code-Nummer auf der Teststreifendose übereinstimmt. Falls notwendig, kodieren Sie das Messgerät neu oder wiederholen Sie die Messung. Sollte das Problem wieder auftreten, kontaktieren Sie den lokalen Vertriebspartner.
E-U	Benutzter Teststreifen oder elektronisches Problem	Wiederholen Sie die Messung mit einem neuen Teststreifen. Sollte das Problem wieder auftreten, rufen Sie uns unter der auf der Packung angegebenen Telefonnummer an.
E-9	Teststreifen wurde zu früh aus dem Messgerät entfernt.	Wiederholen Sie die Messung mit einem neuen Teststreifen.
E-A	Ein internes Problem am Messgerät ist aufgetreten.	Wiederholen Sie die Messung mit einem neuen Teststreifen. Sollte das Problem wieder auftreten, rufen Sie uns unter der auf der Packung angegebenen Telefonnummer an.

E-1	Es gibt interne Probleme der Festlegung von Parameterwerten innerhalb des Messgerätes.	Wiederholen Sie die Messung mit einem neuen Teststreifen. Sollte das Problem wieder auftreten, rufen Sie uns unter der auf der Packung angegebenen Telefonnummer an.
E-8	Blutprobe zu klein, um eine korrekte Messung durchzuführen	Wiederholen Sie die Messung mit einem neuen Teststreifen. Vergewissern Sie sich, dass genug Blut für die Messung zur Verfügung steht.
HI	Messergebnis ist höher als 600 mg/dl	Waschen und trocknen Sie Ihre Hände und wiederholen Sie die Messung mit einem neuen Teststreifen. Ist das Ergebnis wieder HI, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt und medizinisches Betreuungspersonal.
LO	Messergebnis ist niedriger als 20 mg/dl	Waschen und trocknen Sie Ihre Hände und wiederholen Sie die Messung mit einem neuen Teststreifen. Ist das Ergebnis noch immer LO, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt und medizinisches Betreuungspersonal.

SYMBOLE

	Ablaufdatum (gültig bis Ende des Monats)
LOT	(LOT) Chargennummer
4°C 39°F 30°C 86°F	Temperaturlimits
	Wenden Sie sich an die Gebrauchsanweisung
IVD	In Vitro Diagnostisches Medizinprodukt
	Achtung, konsultieren Sie die Begleitpapiere
REF	Katalognummer
	Vermeiden Sie Sonnenlicht/direktes Licht
	Nicht wiederverwenden
	Hersteller
FOR SELF-TESTING	In Vitro diagnostisches, medizintechnisches Gerät zur Eigenanwendung

HERSTELLERGARANTIE

Der Hersteller gewährt für das Wellion LUNA Duo Style Messgerät Garantie für Material- und Herstellungsdefekte über einen Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum. Diese Garantie geht verloren, wenn das Gerät nicht bestimmungsgemäß verwendet, schlecht gewartet oder geöffnet wurde.

Gewährleistung unter dieser Garantie ist beschränkt auf die Reparatur defekter Teile oder – nach Maßgabe des Herstellers – auf Ersatz des Geräts. Das Recht auf Kaufrücktritt gilt nur, wenn auch die Ersatzware defekt ist. Andere Ansprüche können nicht anerkannt werden.

Die Garantie tritt außer Kraft, wenn die Beschädigung aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch, grober Behandlung, Öffnen des Geräts, menschlichem Versagen oder Anwendung unter extremen Bedingungen resultiert.

Die Garantie ist ausschließlich gültig, wenn Datum, Stempel und die Unterschrift des Händlers am Tag des Kaufs vermerkt werden.

Die Garantiedauer kann nicht durch Ansprüche im Rahmen dieser Garantie verlängert werden.

SPEZIFIKATIONEN

Messprinzip:	Elektrochemischer Biosensor
Kalibration:	Plasma
Blutprobe:	Frisches kapilläres Vollblut
Messdauer:	5 Sekunden (Glukose) 26 Sekunden (Gesamtcholesterin)
Messbereich:	Glukose 20 - 600 mg/dL Gesamtcholesterin 100 – 400 mg/dL
Probenvolumen:	0,5 Mikroliter (Glukose) 10 Mikroliter (Gesamtcholesterin)
Hämatokritbereich:	25 - 60% (Glukose) 35 - 50% (Gesamtcholesterin)
Speicher:	410 Testergebnisse mit Datum und Zeit (360 für Glukose, 50 für Gesamtcholesterin)
Betriebstemperatur:	4 - 45°C
Lagerungstemperatur:	Teststreifen 4 – 30°C Messgerät 0 – 60°C

Lagerung Relative Luftfeuchtigkeit:	10 - 90%
Batterie:	eine 3V (CR2032) Lithium Batterie
Batterielebensdauer:	1000 Messungen oder 1 Jahr im kontinuierlichen Gebrauch
Maße:	78 x 47 x 13 mm
Gewicht:	ca. 34 g (mit Batterie)

Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung der Wellion LUNA Teststreifen. Messung an alternativen Teststellen (AST) möglich.

Software Version BKM-13-6-Y

Ihre ÖSTERREICHISCHE Diabetesmarke

wellion®

AUSTRIA

CE 0408

IVD In Vitro diagnostisches, medizintechnisches Gerät

MED TRUST
THE MEDICAL SERVICES COMPANY

MED TRUST Handelsges.m.b.H.
Gewerbepark 10
7221 Marz
AUSTRIA
www.medtrust.at

W632SDE RevB 01/2014

© 2012 MED TRUST Handelsges.m.b.H.